Схема записи в счете на аналоговые электроизмерительные приборы

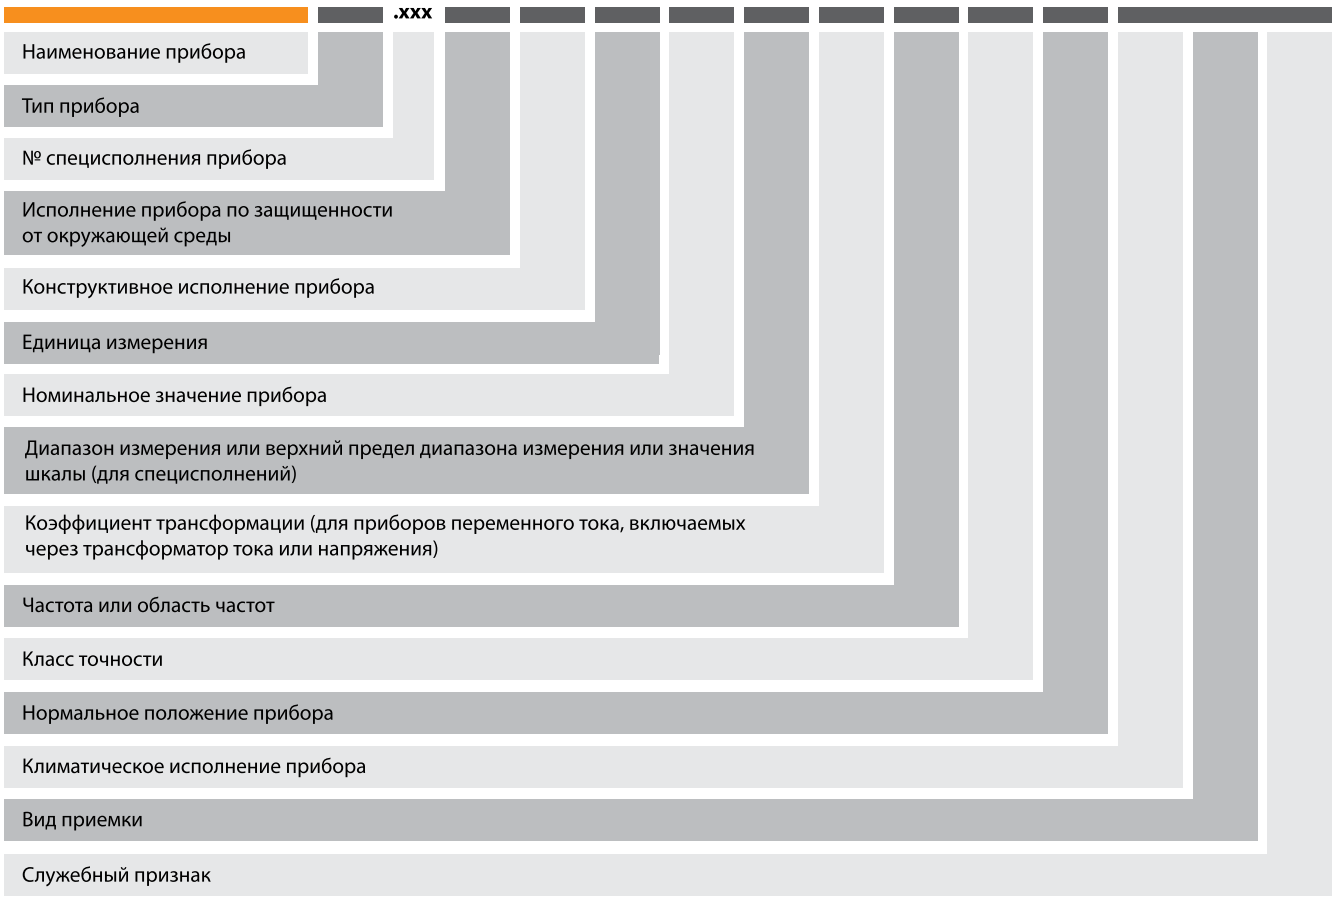

Используются следующие сокращения:

Исполнение прибора по защищенности от воздействия окружающей среды:	пылезащищенное исполнение - не указывается пылебрызгозащищенное исполнение (IP54 по лицевой панели) - Б исполнение для эксплуатации на морских судах - ОМ2
Конструктивное исполнение:	исполнение с повышенными механическими характеристиками - м исполнение с возможностью внешней подсветки шкалы - п исполнение со сменной шкалой - с
Нормальное положение прибора:	вертикальное - В горизонтальное - Г прибор работает в двух положениях - В, Г под углом к горизонту - ХХГ (например 45Г)
(для профильных приборов)	прибор устанавливается вертикально, шкала горизонтальная - П прибор устанавливается вертикально, шкала вертикальная - Е прибор устанавливается горизонтально, шкала горизонтальная - Л прибор устанавливается горизонтально, шкала вертикальная - К прибор устанавливается под углом 45 град. к горизонту, шкала горизонтальная - И прибор устанавливается под углом 45 град. к горизонту, шкала вертикальная - Д под углом к горизонту - ХХГ (например 12Г) прибор работает в двух положениях - М
Климатическое исполнение прибора:	общепромышленное исполнение - О тропическое исполнение - ТК экспортное исполнение - ЭК
Вид приемки:	без приемки военным представительством - О с приемкой военным представительством - П
Служебный признак:	клеймо поверителя на стекле прибора - ПК приборы с серийными номерами (по спецзаказу) - N приборы изготавливаемые для АЭС - А